Работа в MixitCloud при помощи Automatchic

1.Для начала работы, делаем замер образца при помощи Automatchic. Предварительно переименовывая его в удобной для вас форме (например вместо car-.. – test 090718).

2.Затем в вэб-сервисе MixitCloud находим вкладку “Measurements” – это наши измерения. Видим, что программа обнаружила наш Automatchic Vision автоматически. Нажимаем кнопку синхронизации “START SYNCHRONIZATION”

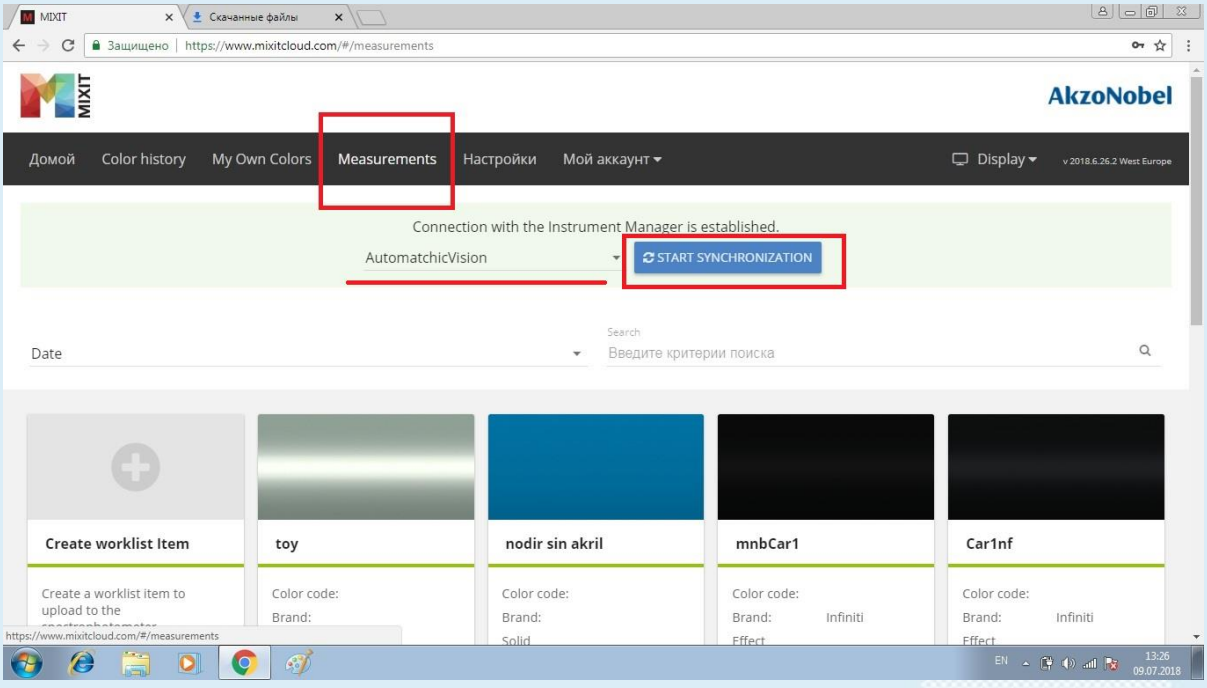

3.После синхронизации, программа отображает замер, который был произведен при помощи Automatchic Vision (test 170718). Находим на нем иконку (изменить замер) и нажимаем

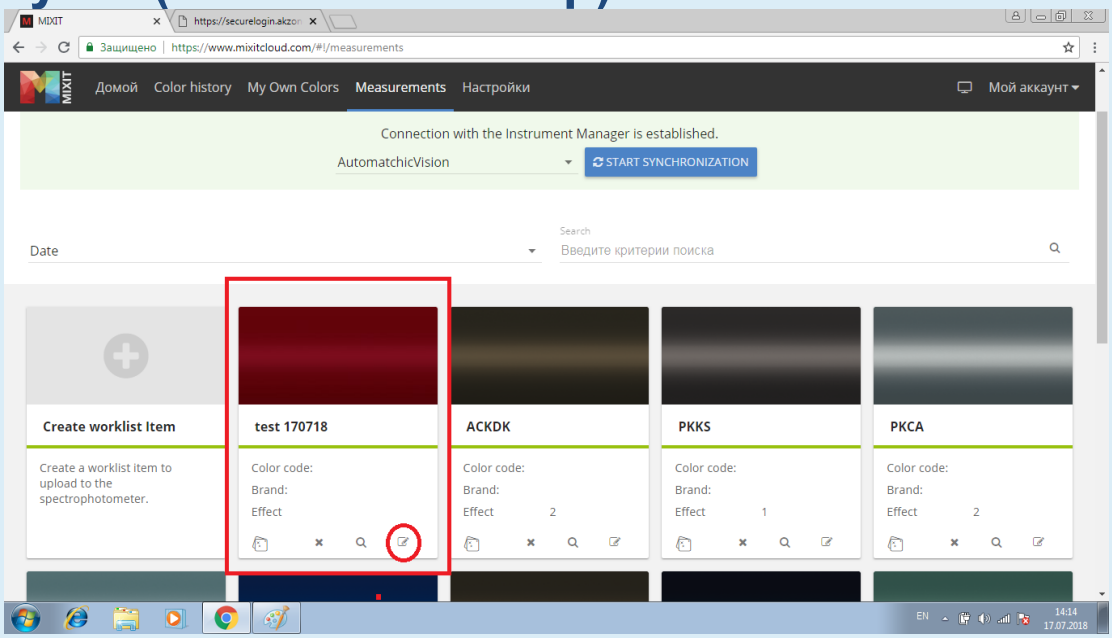

4.Вносим необходимые данные, нажимаем «СОХРАНИТЬ»

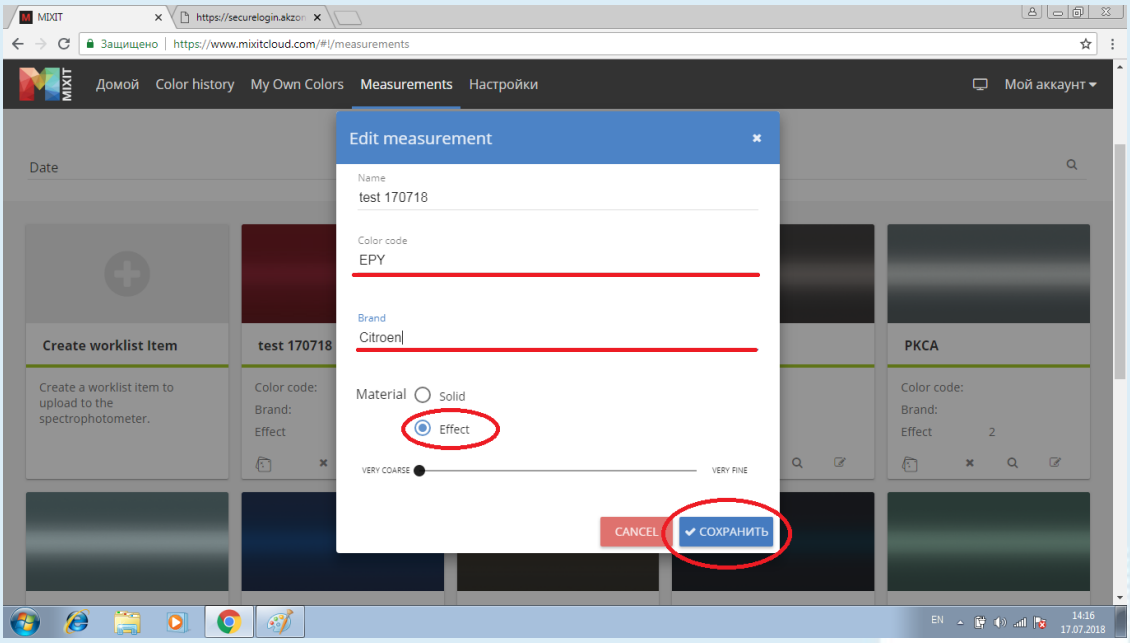

5.Ищим иконку (поиск), нажимаем

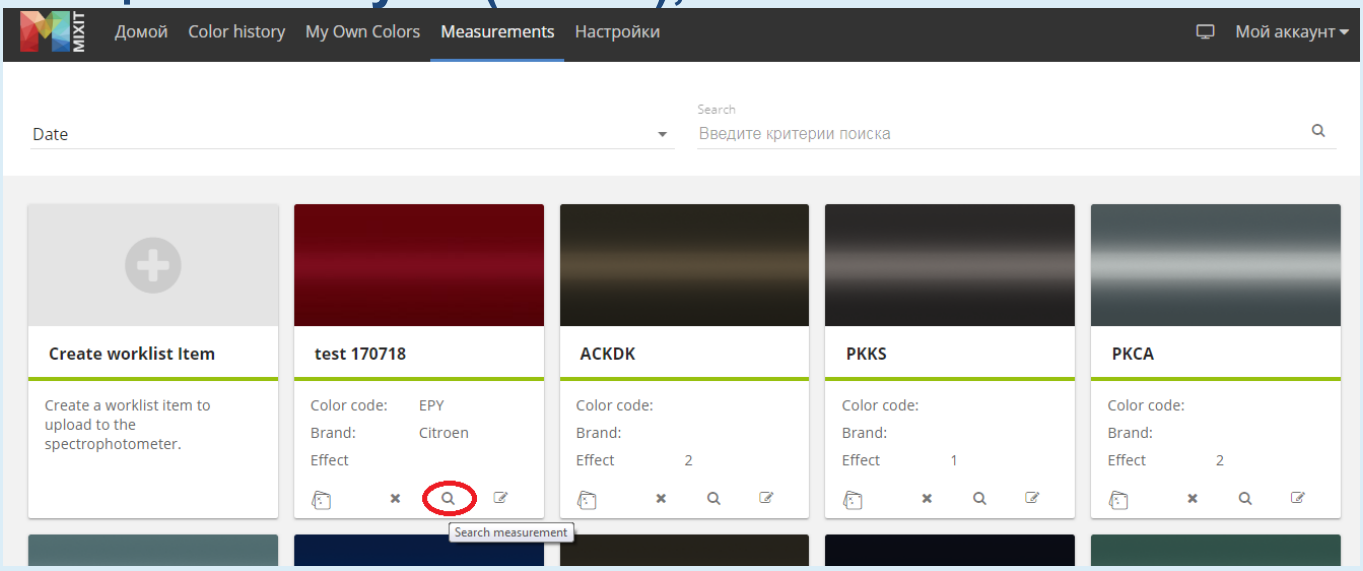

6.Появляются результаты поиска – лучший результат (Best match) и другие результаты (Other match).

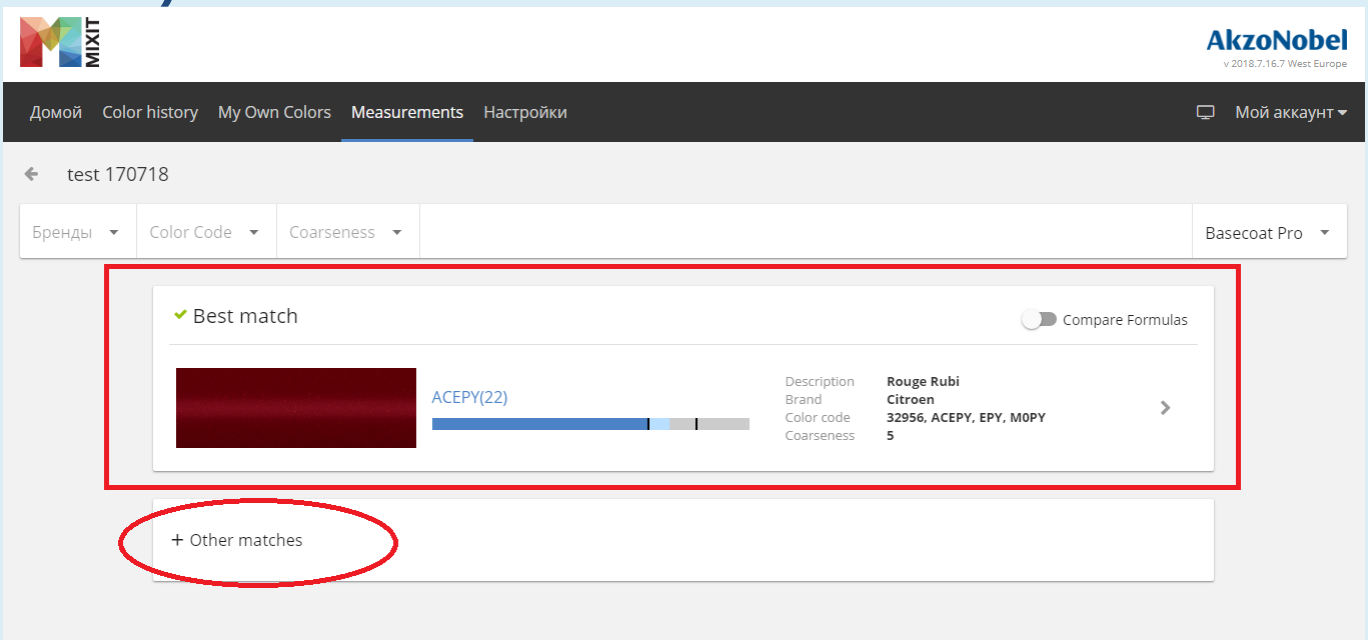

7.Передвигаем флажок «сравнить формулы» (Compare Formulas), нажимаем на + и выбераем несколько более подходящих и нажимаем «сравнить выбор» (Compare Selection)

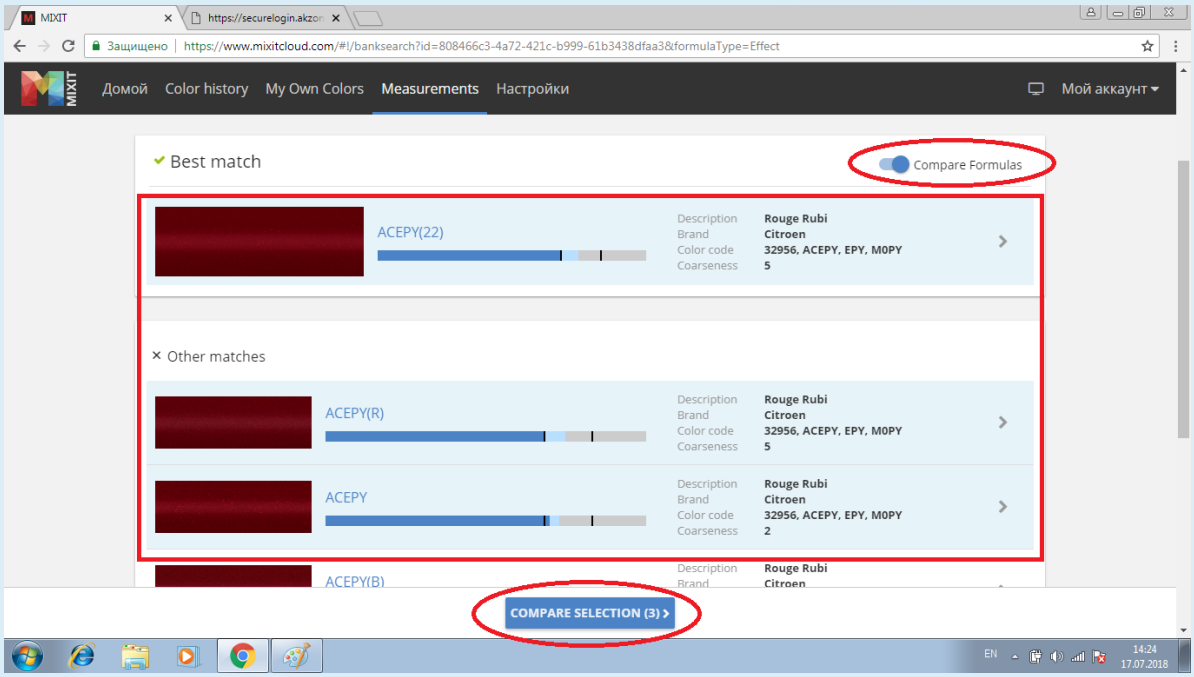

8.Сравниваем формулы. Выбираем наиболее подходящую, кликаем продолжить «CONTINUE»

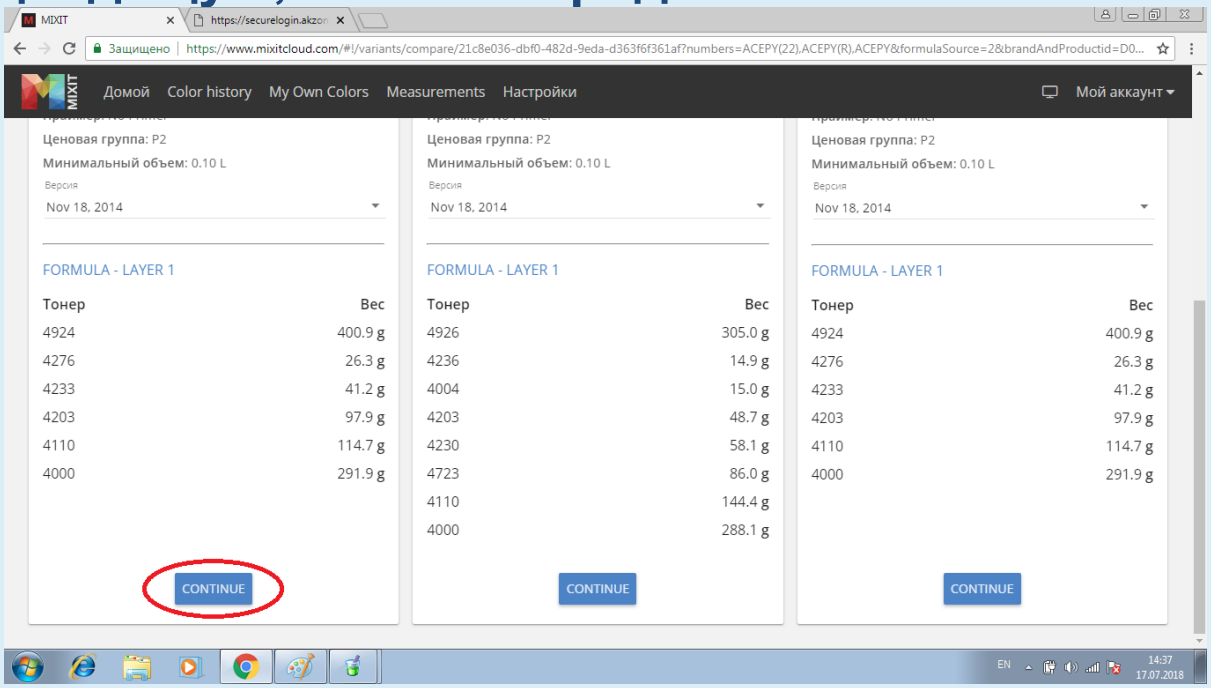

9.Открывается окно с настройками налива. Ставим необходимое количество. Нажимаем «SMART MIX»

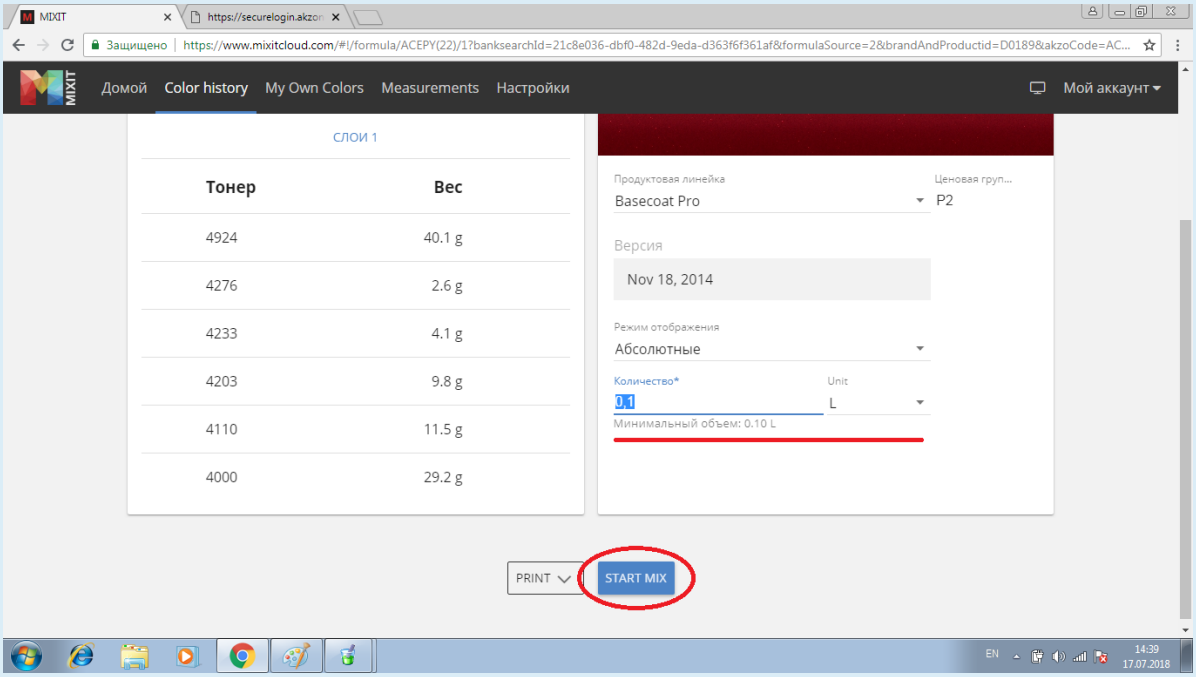

10.Появляется окно с информацией, что нам нужно настроить весы при помощи инструмент менеджера. В панели задач нажимаем «показать скрытые значки». Видим зеленый кружок, кликаем. Нажимаем «Options»

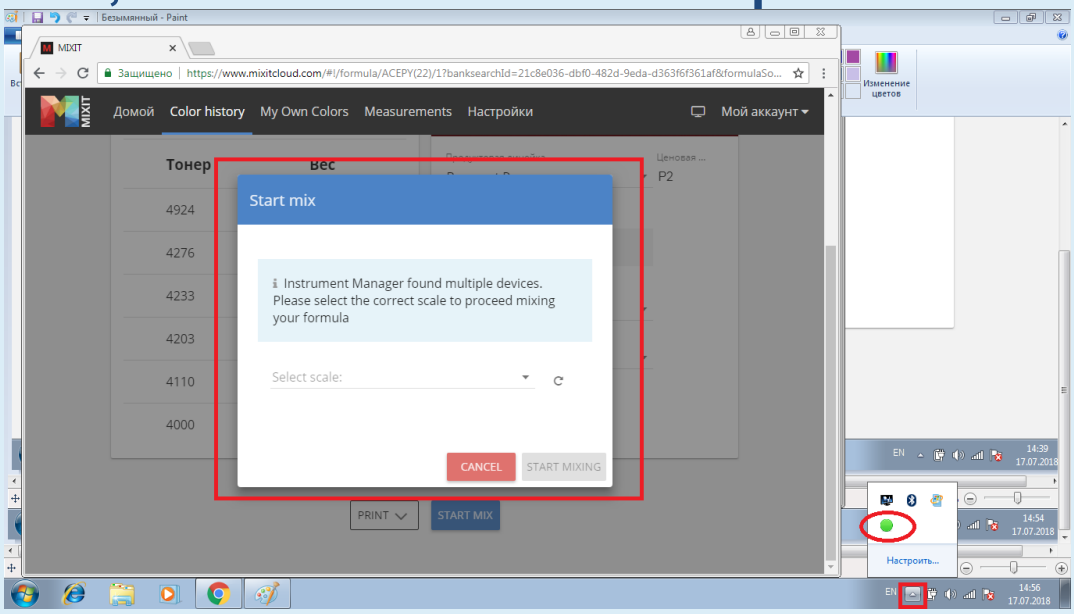

11.Всплывает окно Instrument Manager. Нажимаем «Options»

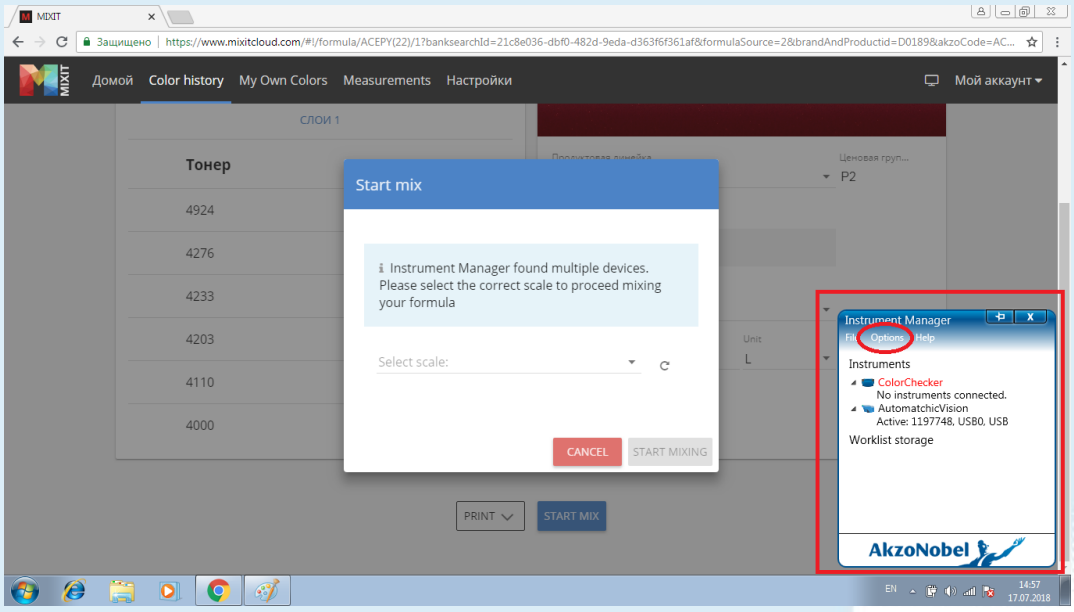

a)Настраиваем COM port

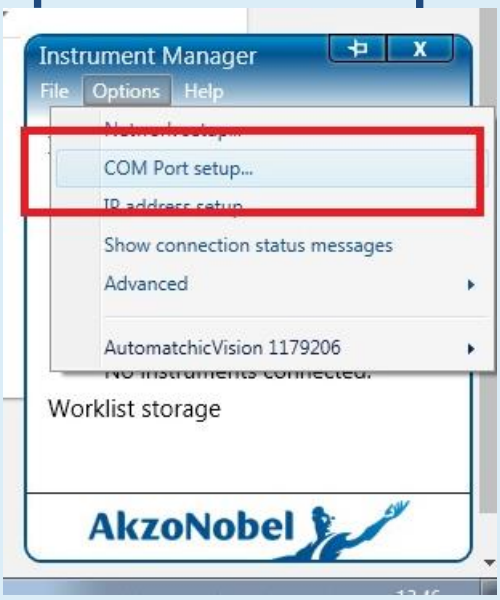

b)Сохраняем

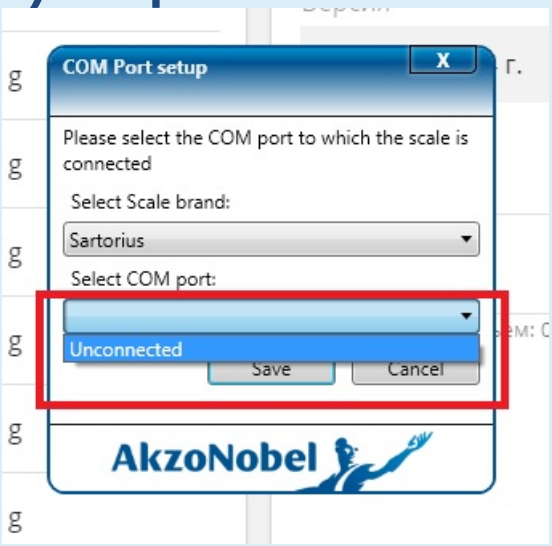

12.После настройки весов нажимаем «START MIXING»

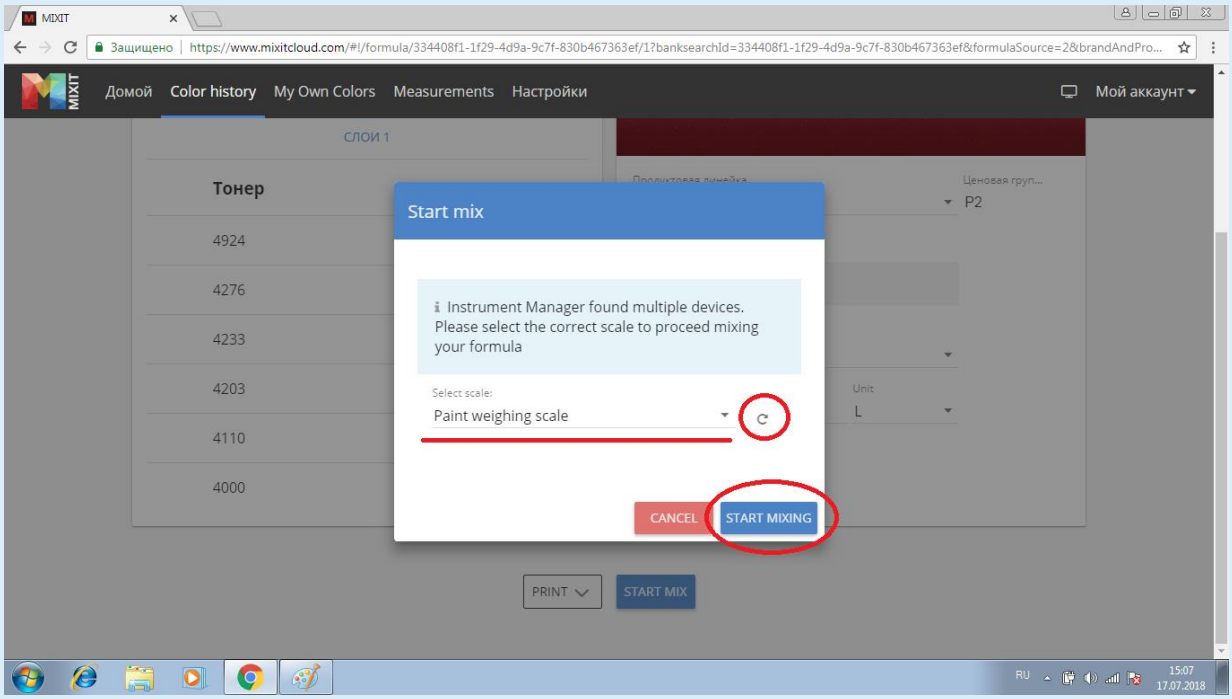

13.Программа сообщает о необходимости установить пустую тару на весы. Устанавливаем тару, нажимаем «ОК»

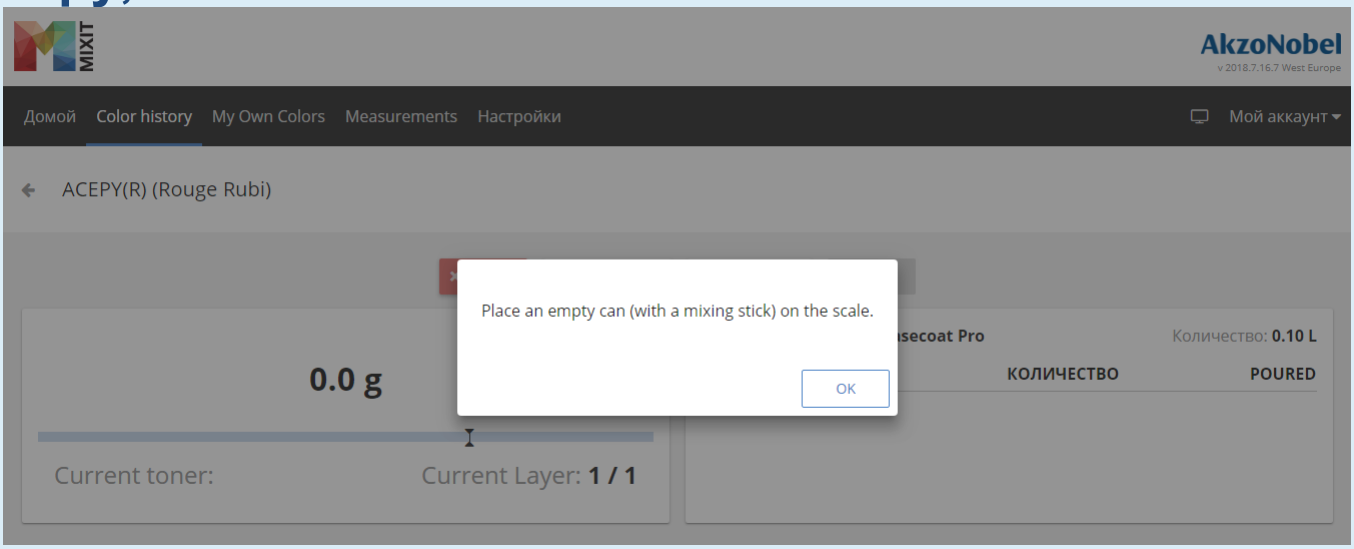

14.Наливаем по очереди каждый компонент и нажимаем«NEXT»

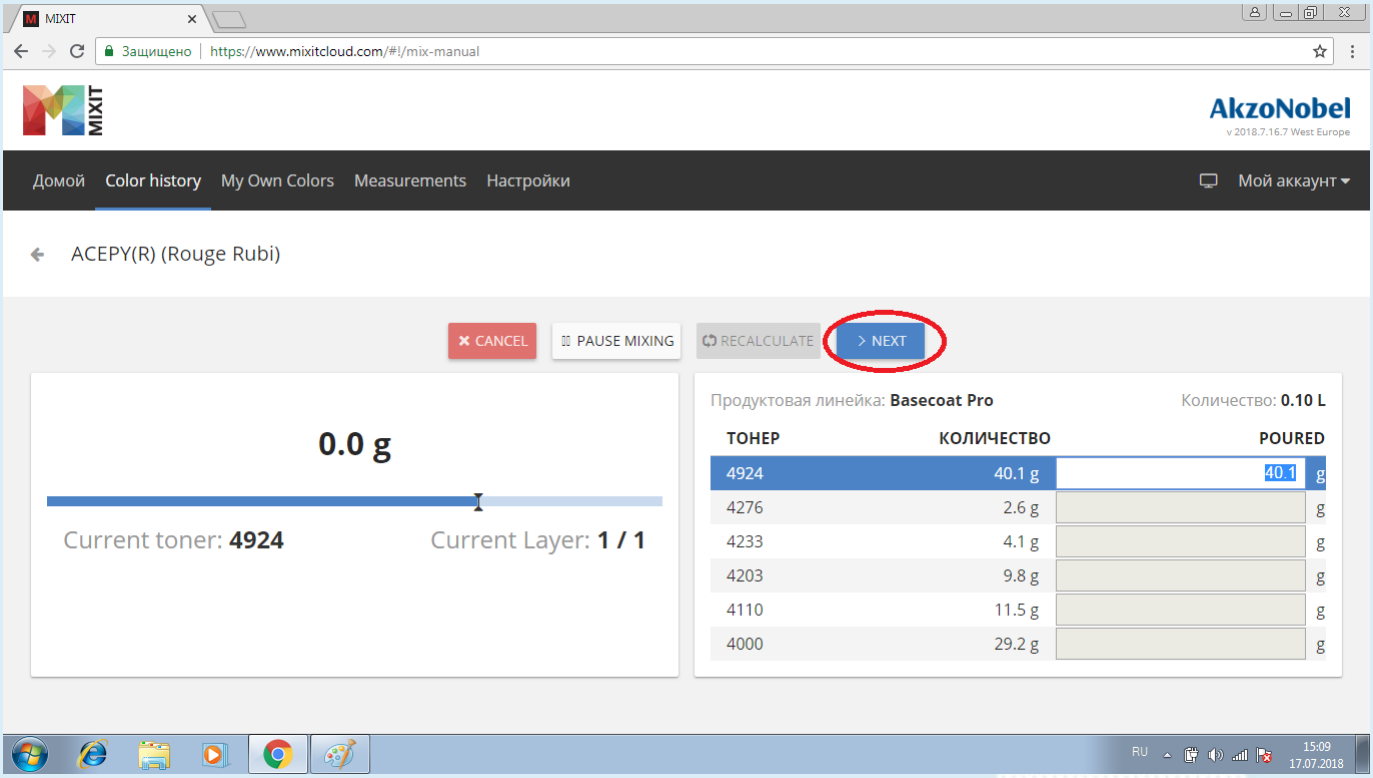

15.После последнего налитого компонента, появляется окно с уведомлением о завершении смеси, подтверждаем нажатием «ОК».

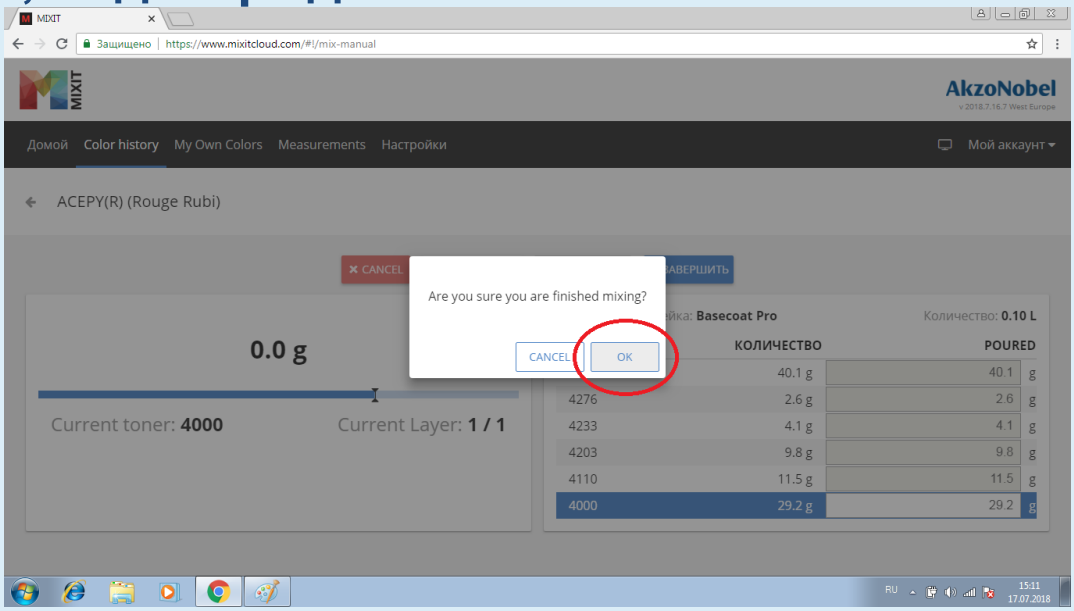

16.Выкрашиваем тест, оцениваем полученный результат. При необходимости автокоррекции, делаем замер выкрашенной тест пластины, предварительно называем замер например «test 1 170718»

17.Переходим в историю цвета “Color History”. Находим иконку «начать коррекцию цвета» - нажимаем

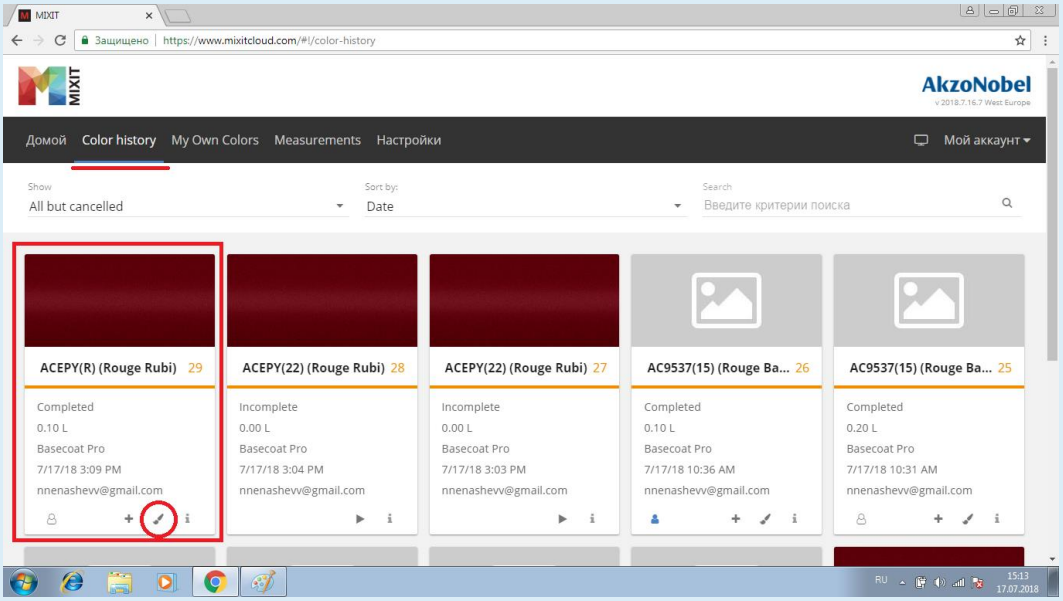

18.Подтверждаем своё намерение откорректировать формулу

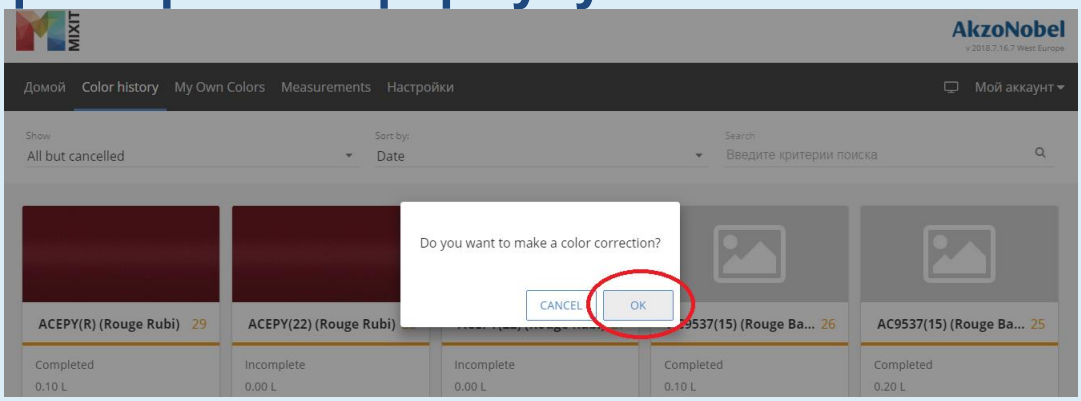

19.Синхронизируем программу с Automatchic Vision

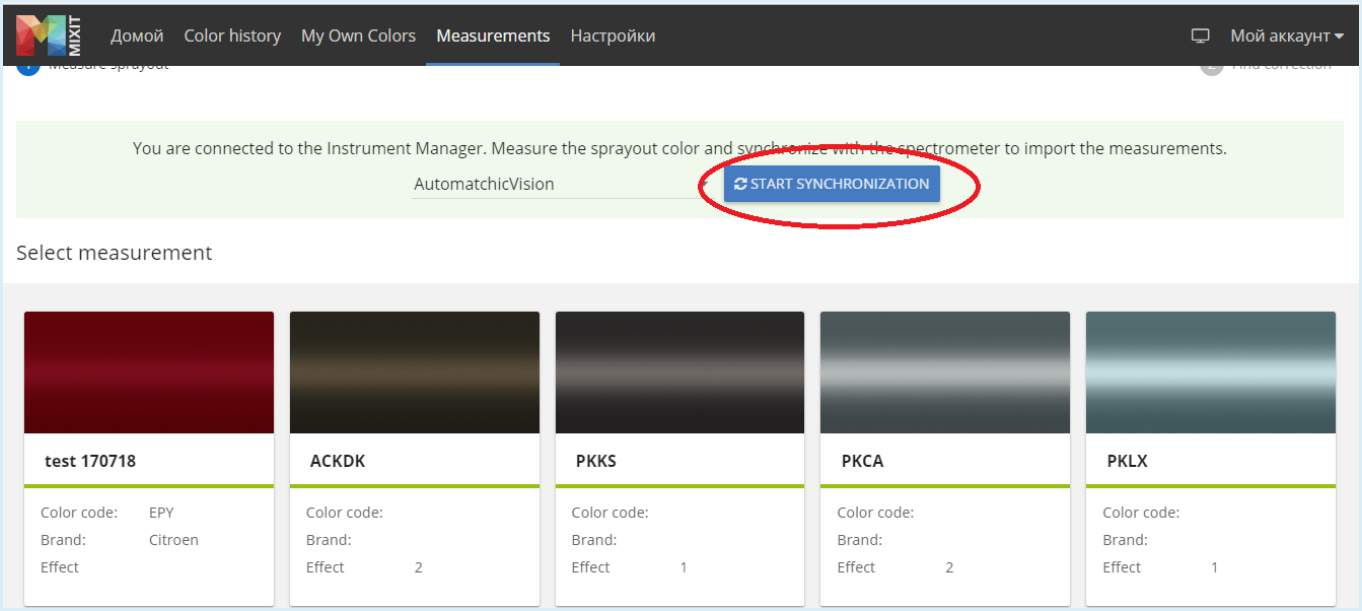

20.Выбираем «test 1 170718»

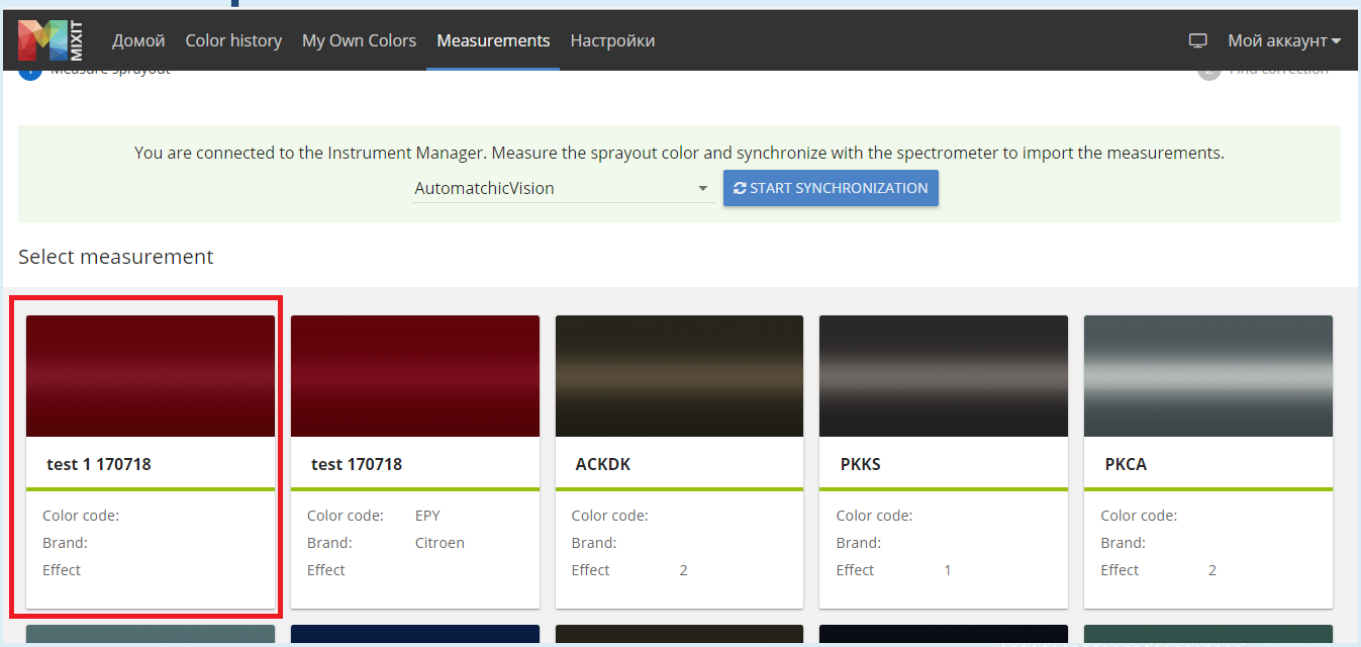

21.Получаем откорректированный результат. Кликаем на иконку >

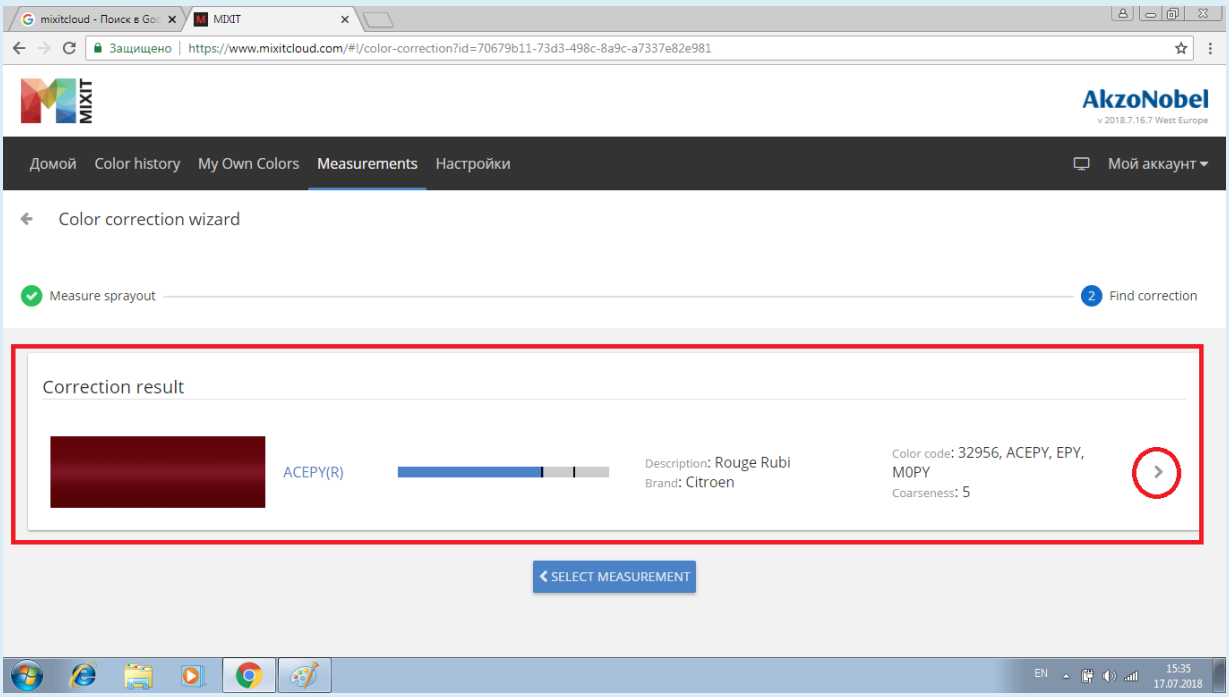

22.Принимаем коррекцию

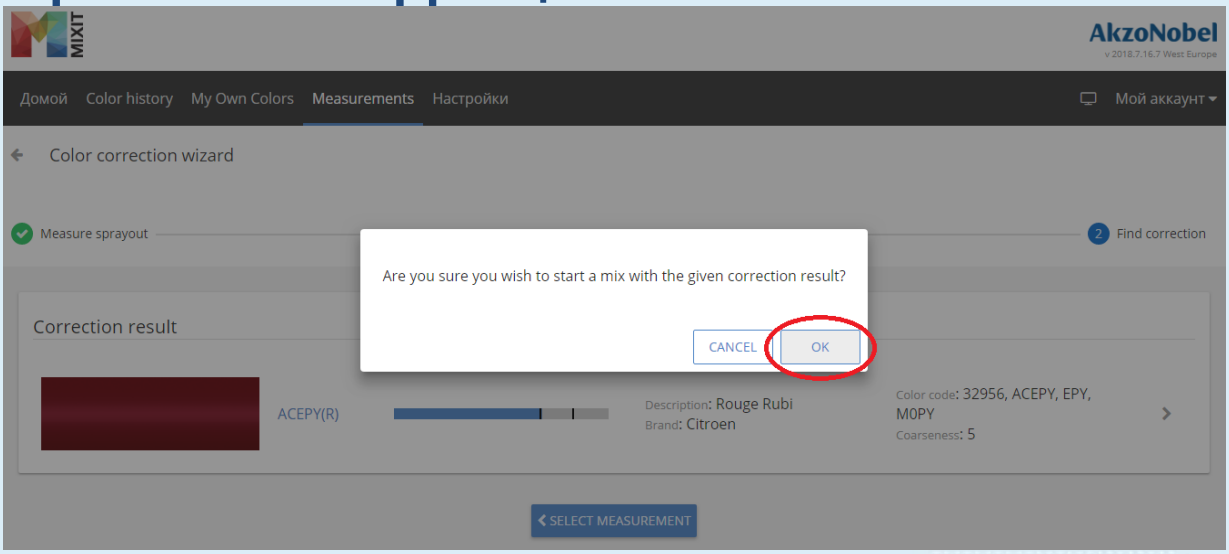

23.Смешиваем компоненты по откорректированной формуле, выкрашиваем тест-пластину, проверяем результат

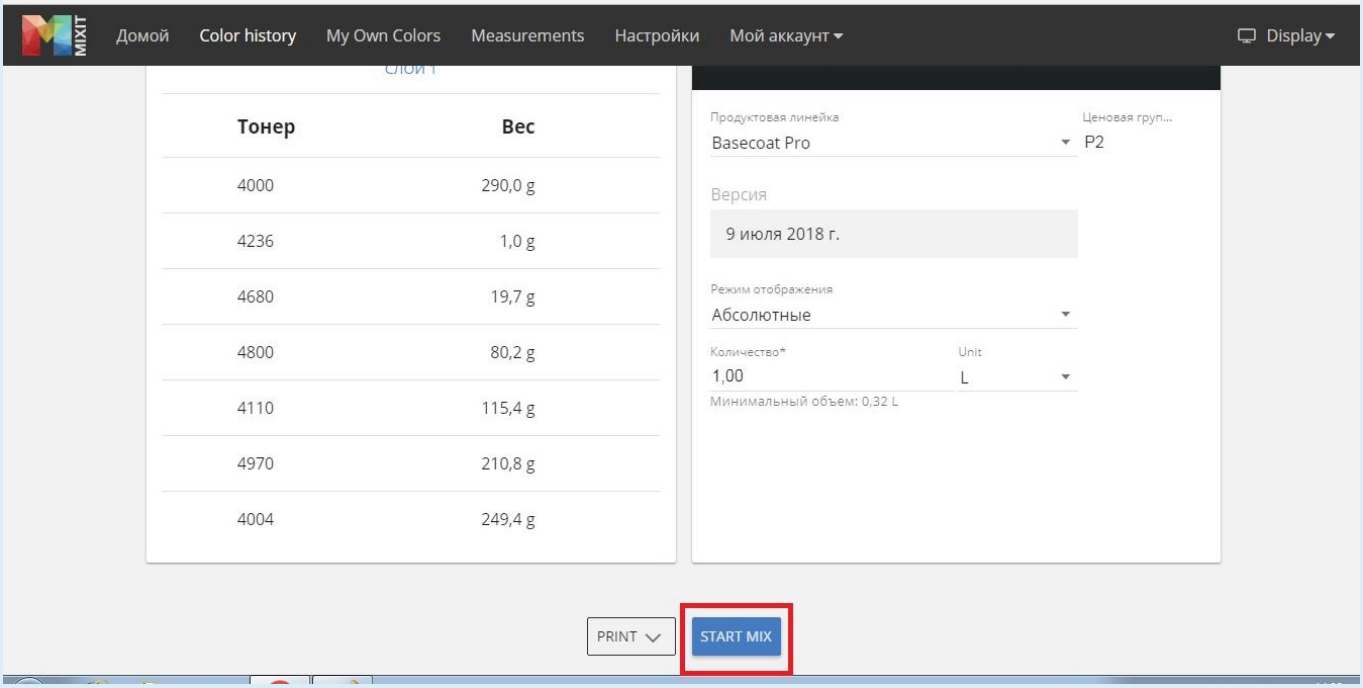

15.Сохраняем полученный результат в свою базу

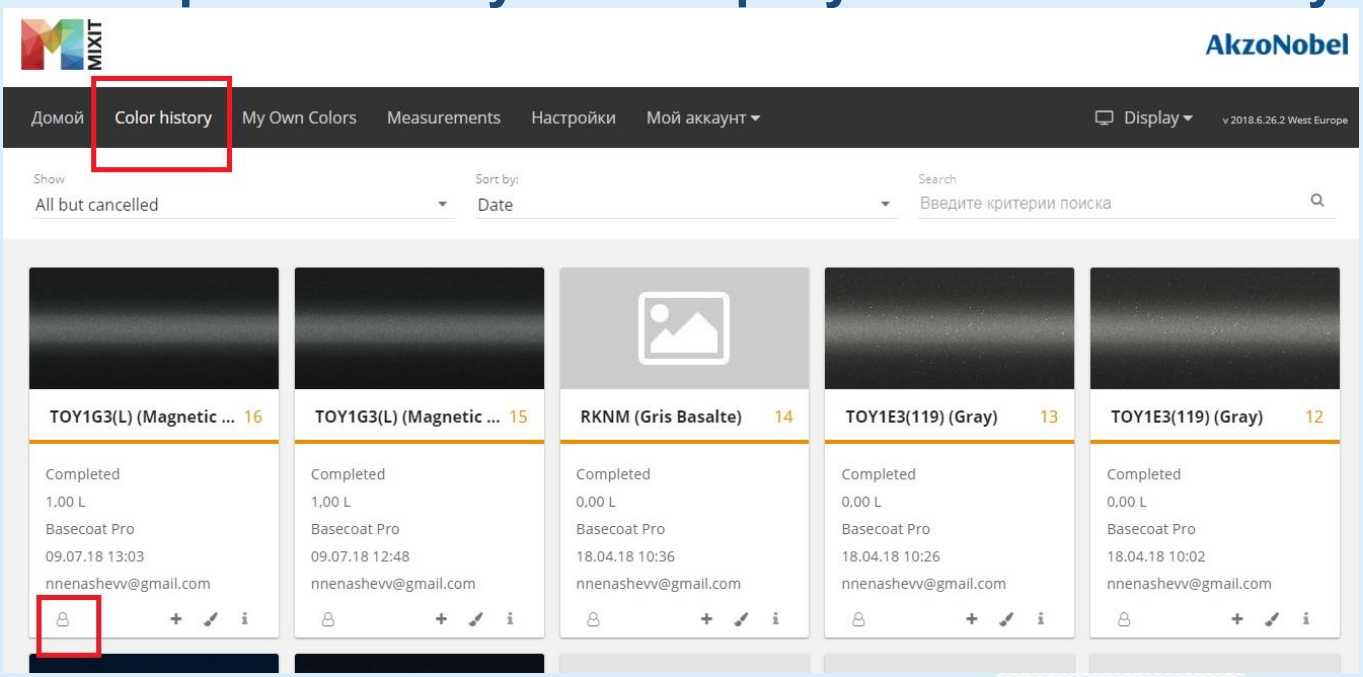

16.Привязываем замер к сохраненной формуле. Переходим в «мои собственные цвета» (My Own Colors), кликаем на иконку редактировать данные

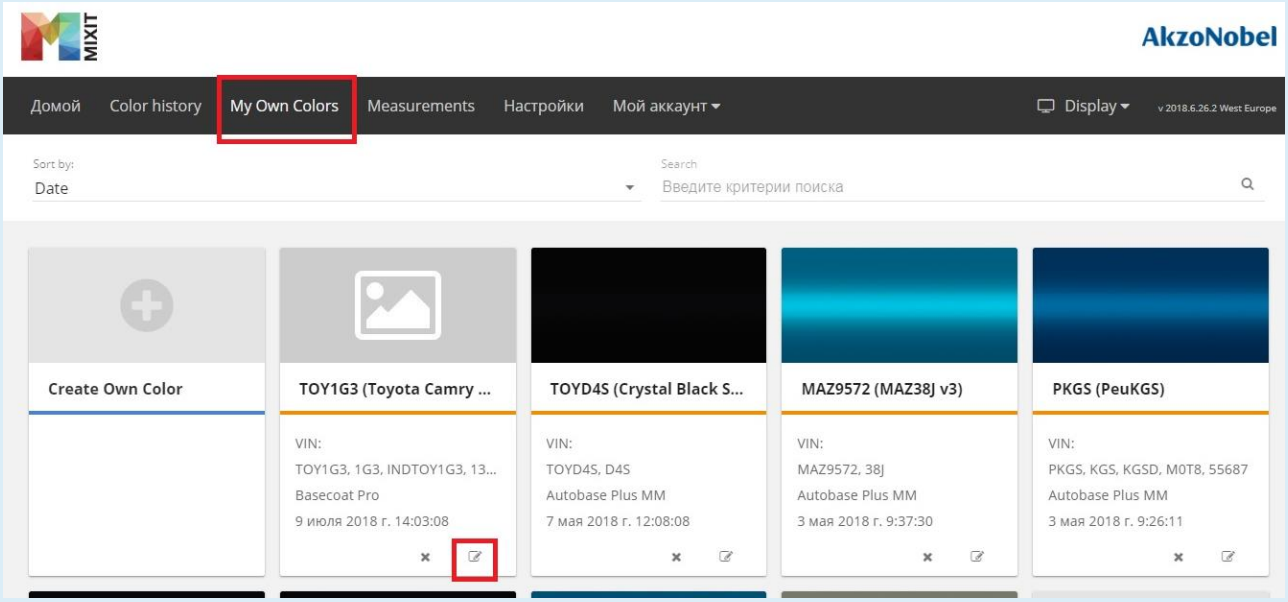

17.Кликаем в область серого фона

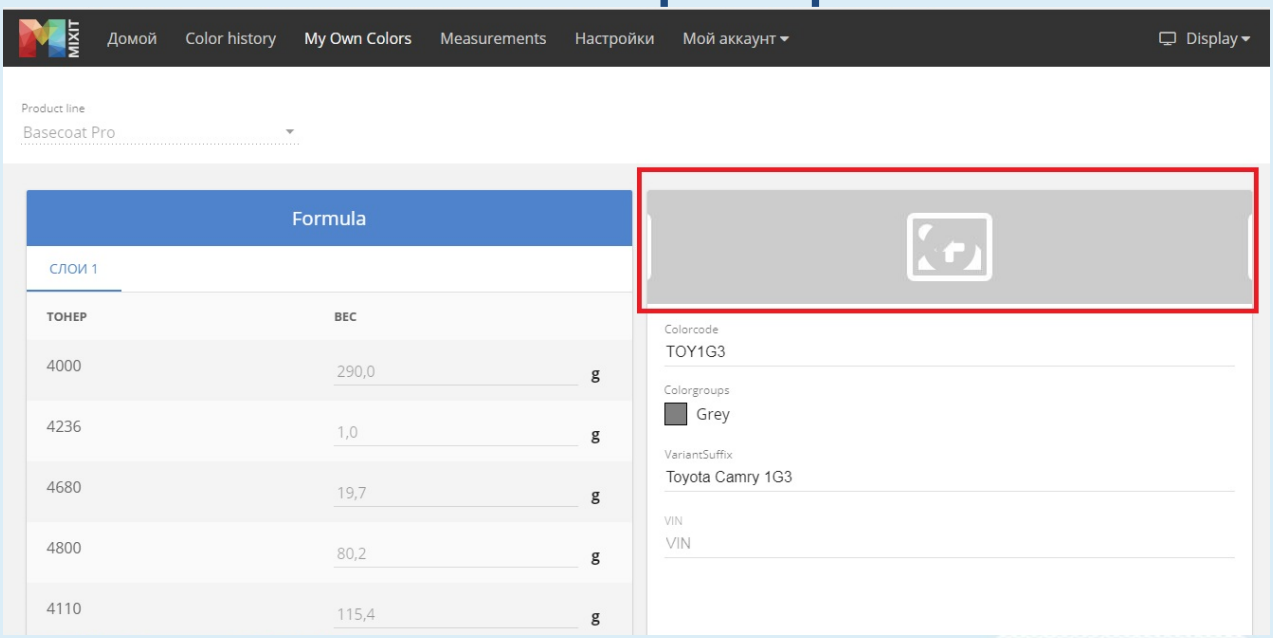

17.Появляется окно измерений. Выбираем необходимый замер, нажимаем «СОХРАНИТЬ»

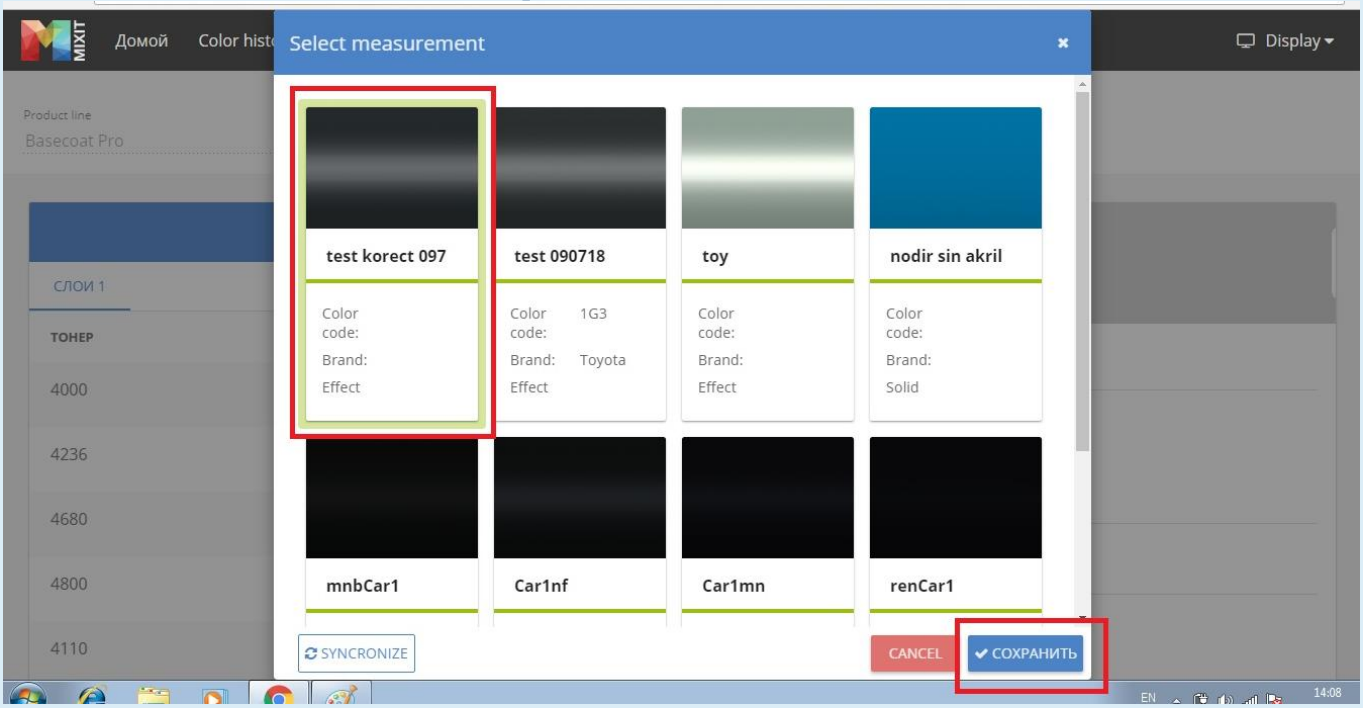

«СОХРАНИТЬ»

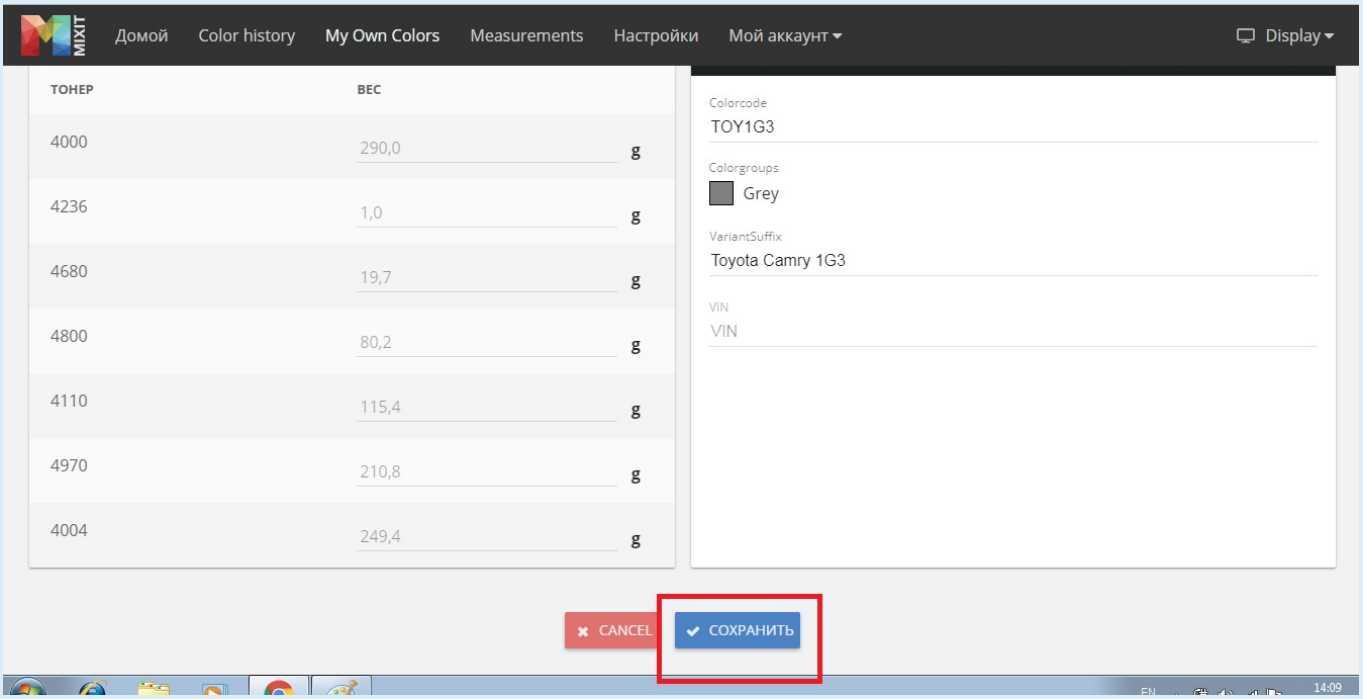
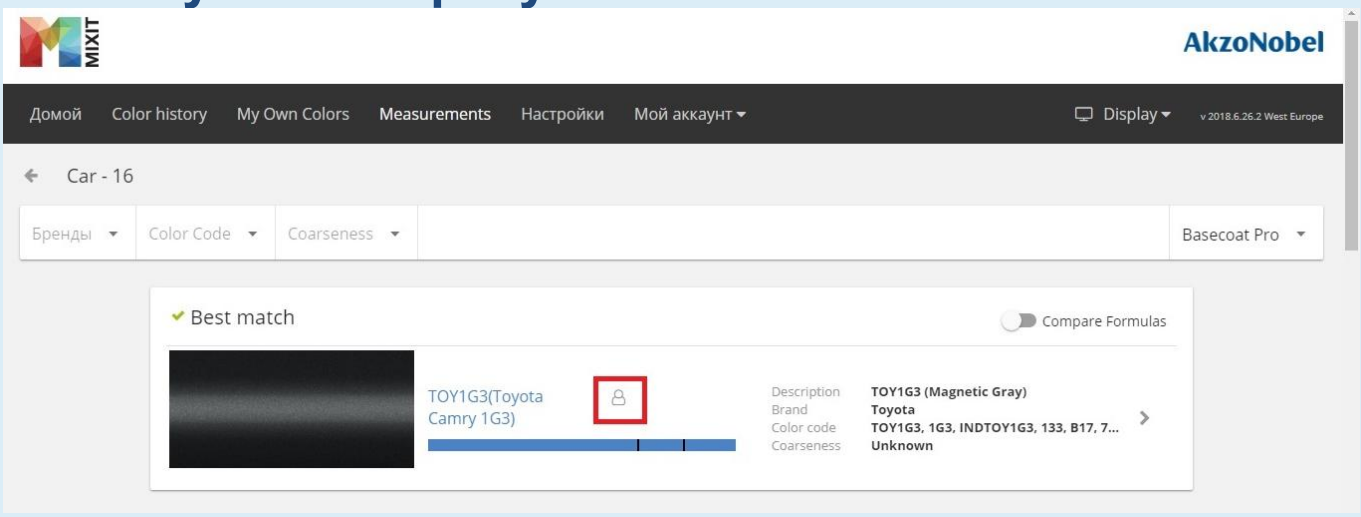
18.Полученный результат